


**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE**

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0604.01/2020
Processo Administrativo Nº 0604.01/2020
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR
Data de Publicação: 14/04/2020 15:26:44




PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE

Total do processo: 84.000,00 Desconto médio: 0,60% Total economizado: 500,00

LOTE 1 Quantidade.: 1 Total lote: 84.000,00 Média lote (%): 0,60% Econ. lote: 500,00

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	<p>Aparelho de Anestesia Aparelho de anestesia para cirurgias em pacientes pediátricos e adultos. Construído em gabinete com estrutura em aço de alto impacto, com pintura epóxi ou material tecnicamente compatível com a finalidade. Bandeja superior para suporte de equipamentos de monitorização extras, saída serial RS 232. Dotado de gavetas e rodízios com travas nas rodas dianteiras. Permitir também a utilização através de cilindro de O2, rotâmetro com indicação dos fluxos ajustados de cada gás (O2 e N2O), com escala para oxigênio 0,5 a 10l/min e óxido nitroso 0,5 a 10l/min. Sistema de segurança contra hipóxia que garanta uma mistura de no mínimo 25% de O2, sistema que corta o fluxo de O2 na ausência de N2O, fluxo de oxigênio direto de no mínimo 35 a 75l/min. Deve dispor de botão de oxigênio diferente dos demais para uma pronta identificação deste; Filtro valvular permitindo o reaproveitamento dos gases expirados pelo paciente com canister coaxial com capacidade de 750ml de cal sodada, balão reservatório de 5lts. Vaporizador universal microprocessado com intercâmbio de câmaras; sistema de indicação do agente anestésico em uso, display eletrônico com tabela de concentrações x fluxo de borbulhamento, dois cônicos para o fluxo de borbulhamento com escalas diferenciadas para alto 500 a 2000ml/min e baixo fluxo de 10 a 300ml/min, possuir sistema de proteção contra o fornecimento de agente anestésico sem que haja fluxo de oxigênio. Ventilador pulmonar que permita ventilação mecânica no modo CMV, atendendo aos seguintes parâmetros: Volume Corrente de 350 a 1000ml, pressão máxima de 10 a 70cmH2O, relação I:E 1:1 a 1:5, fluxo inspiratório de 5 a 50l/min. Sistema de alarme para desconexão, pressão máxima inspiratória, pressão de O2, bateria. Manômetro de pressão endotraqueal com escala de - 0 a 80 cm H2O; aspirador com frasco de 500ml, fluxometro de O2 15l/min. Alimentação 110 ou 220Volts, 50/60Hz., com bateria interna recarregável suficiente no mínimo de 1(uma) hora de uso.</p>	1	84.000,00	83.500,00	0,60%	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
MUCAMBO-CE

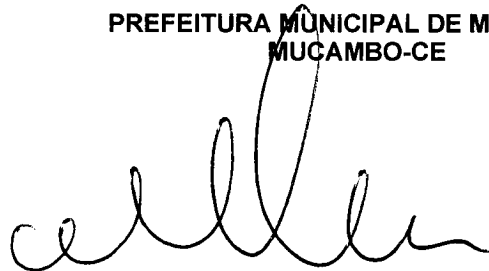

PREGOEIRO: FRANCISCO ORÉCIO DE ALMEIDA AGUIAR

