Cliente: 57114-PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO
Att: COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Referente: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Endereço: RUA CONSTRUTOR GONÇALO VIDAL, 0 - CENTRO
CEP: 62170-000 - MUCAMBO/CE

Pregão: 2205.01/2020
Dt Abert: 29/05/2020

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 29/05/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O TRATAMENTO DOS PACIENTES DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), EM CARÁTER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA URGÊNCIA DO OBJETO EM QUESTÃO DO ENFRETAMENTO DE EMERGENCIA DE SAÚDE INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MUCAMBO.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R$ Unt	R$ Total
7	TERMÔMETRO LASER DIGITAL ADULTO E INFANTIL ESTE TERMÔMETRO É SUPER MODERNO E FÁCIL DE UTILIZAR, NÃO INCOMODANDO A CRIANÇA COMO ACONTECE COM OS ANTIGOS TERMÔMETROS. SEU FILHO NÃO VAI SE INCOMODAR QUANDO VOCÊ TIVER QUE MENSURAR A TEMPERATURA DELE, PORQUE ESTE TERMÔMETRO É DIGITAL E INFRAVERMELHO, BASTANDO APONTAR NA TESTA OU NO OUVIDO, A UMA DISTÂNCIA ENTRE 5 A 15 CM, EM APROXIMADAMENTE 5 SEGUNDOS A MENSURAÇÃO DA TEMPERATURA APARECERÁ COM PRECISÃO NO VISOR. CARACTERÍSTICAS - 100% NOVO - DIGITAL - TEMPO MÁXIMO PARA MEDIÇÃO: 5 SEGUNDOS - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA BATERIA: 7 SEGUNDOS - ALIMENTAÇÃO: PILHA - TEMPERATURA DE TRABALHO: 10 A 40 °C - MIRA LASER PARA ACERTAR O ALVO COM PRECISÃO - TEMPERATURA RELATIVA: 85% - RESOLUÇÃO MÍNIMA: 0,1 °C - PRECISÃO: ± 0,1 ° C - FAIXA DE MEDIÇÃO: 32,0 A 43,0 °C (90 A 109 °F) - ERRO MÁXIMO: 0,3°C- DISTÂNCIA IDEAL PARA MEDIDAS: 5 A 15 CM ITENS INCLUSO: 1 X TERMÔMETRO CORPORAL 2X BATERIAS AA	GTECH	8	UND	528,8000	4.230,40
8	BOMBA DE INFUSÃO 1 VIA DE FUNCIONAMENTO CONTINUO VILUMETRICA PARA ADULTO.A BOMBA VOLUMETRIC MEDIFUSION MP-1000 DA INFUSÃO DA BOMBA GERAL DA INFUSÃO DA DIVISÃO PODE SER USADA PARA A INFUSÃO DA TAXA DE FLUXO CONTÍNUO DAS DROGAS FLUIDAS E DA TRANSFUSÃO EM ICU OU O CCU ASSIM COMO A INFUSÃO DOS ANESTÉSICOS, DE AGENTES ANTICANCEROSOS OU DE NUTRIENTE. MUITOS DE JOGOS DO PADRÃO IV PODEM SER CALIBRADOS NA BOMBA MP-1000 DA INFUSÃO. EXPLANAÇÃO. O MICRO MOTOR DE PISO REDUZ O RUÍDO DEIXE CAIR A VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DOBRO DO SENSOR, VERIFICAÇÃO VAZIA DO ESCANINHO. SENSOR DO ULTRA - SOM PARA O SENSOR DO AR DETEÇÃO MAIS ALERTA & MAIS EXATA. MONITORE A UNIDADE DE BOMBEAMENTO, VELOCIDADE DO MOTOR, VERIFICAÇÃO DO PROCESSADOR CENTRAL, VERIFICAÇÃO DA GOTA.ACIMA DE & PARA BAIXO DA OCLUSÃO SENSOR CE MARCADO, IEC SATISFEITO, SEGURANÇA DA COMPATIBILIDADE ELETRÔNICA CARACTERÍSTICAS 1. COMPATÍVEL COM OS MUITOS DE JOGOS DO PADRÃO IV 2. ESCALA LARGA DO ~ 999 ML/H DA TAXA DE FLUXO 0.1 3. FUNÇÃO DE MEMÓRIA 4.FUNÇÃOVARIÁVELDOALARME 5. A SEGURANÇA CARACTERIZA O SENSOR DA GOTA, BOTÃO DA PROTEÇÃO DA GOTA LIVRE 6.INDICADOR CONVENIENTE DA BATERIA 7. RECOLOCAÇÃO FÁCIL DA BATER.	SKU IP 001	1	UND	9.939,0000	9.939,00

Av. Capitão Hugo Bezerra, nº 181 - Barroso - Fortaleza/CE - CEP: 60862-730 - CNPJ: 09.485.574/0001-71
IE: 06.830.475-7 - Fone: (85) 3452.3100 - Filial Juazeiro: (88) 3571.3151 - prohospital@prohospital.com.br

Total Global: **R$ Global** 14.169,40

CATORZE MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 2205.01/2020 e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.
*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.

*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2
*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.
*OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 12 (DOZE)MESES
*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TECNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA Á AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N°.181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARÁ

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 05 (CINCO) DIAS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

Mª Carolina S. dos Santos

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
MARIA CAROLINA SOUSA DOS SANTOS
CPF: 657.706.763-53

Av. Capitão Hugo Bezerra, nº 181 - Barroso - Fortaleza/CE - CEP: 60862-730 - CNPJ: 09.485.574/0001-71
IE: 06.830.475-7 - Fone: (85) 3452.3100 - Filial Juazeiro: (88) 3571.3151 - prohospital@prohospital.com.br

Cirúrgica Parma Ltda- ME
Materiais Médicos e Ortopédicos
CNPJ: 10.368.534/0001-29 INSC: 189.177.607-116
Rua General Glicerio.286. Vila Central CEP: 19.806.240
Tel. (43) 3344-5020. E-mail:cirurgicaparma@gmail.com
CEP: 19806-240 - ASSIS SP
Assis **São Paulo**

Ao
Município de Mucambo - Ceará,
Setor de Licitações
PREGOEIRA: SR. Francisco Orécio de Almeida Aguiar
Rua Construtor Gonçalo Vidal, S/N - Centro - CEP 62.170-000 - Mucambo - Ceará

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 2205.01/2020.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 30.717,00

LOTE 1 Total: 2.930,00
Descrição: AMBU REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO COMPLETO.O ambu reanimador tem como função promover a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio para o pulmão. É utilizado na ausência de respiração natural, geralmente ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento, entre outros. Características do produto: Balão em silicone translúcido autoclavável; Tamanho adulto: balão com 1600ml; Máscara facial de silicone autoclavável; Válvula unidirecional, modelo bico de pato, autolavável; Com reservatório de 2500ml não autoclavável; Com extensão plástica (tubo). Balão em silicone autoclavável adultos com 1600ml; Máscara facial em silicone autoclavável; Válvula unidirecional autoclavável; reservatório de 2500 ml não autolavável; Com extensão plástica (tubo);
Quantidade: 10 Valor Unit.: 293,00 Unidade: UNIDADE
Total Item: 2.930,00 Marca: FARMATEX Modelo: ADULTO

LOTE 2 Total: 3.290,00
Descrição: AMBU EM SILICONE COM RESERVATÓRIO - INFANTIL Características: Balão em silicone translúcido autoclavável (Infantil 500ml),Máscara facial em silicone, Válvula unidirecional (Bico de pato) Reservatório não autoclavável (Infantil 1000ml) Indicação:O Ambu Infantil em Silicone com Reservatório também conhecido como Reanimador Manual, promove a ventilação artificial, enviando o ar enriquecido de oxigênio ou ar comprimido para o pulmão do paciente em casos de afogamento, asfixia por substâncias tóxicas, infarto entre outros.
Quantidade: 10 Valor Unit.: 329,00 Unidade: UNIDADE
Total Item: 3.290,00 Marca: FARMATEX Modelo: INFANTIL

LOTE 5 Total: 1.998,00
Descrição: KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO COM 6 LÂMINA CURVA Kit destinado para examinar as vias aéreas. Contém: Cabo Para Laringoscópio Standard Médio Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento; Simples conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de carregamento aberta; Acabamento estriado; Tamanho: Médio; As pilhas para alimentação do cabo (modelo C) devem ser adquiridas separadamente. Lâmina Laringoscópio Convencional Curva Tamanhos de 0 até 5. Lâmina de Laringoscópio convencional; As arestas arredondadas da lâmina de Macintosh reduzem o risco de lesão; Autoclaváveis até 134°C cerca de 4.000 vezes. Nenhum efeito adverso no uso de ETO, autoclavagem a vapor; Acompanha lâmpada.
Quantidade: 2 Valor Unit.: 999,00 Unidade: UNIDADE
Total Item: 1.998,00 Marca: MD Modelo: KIT

LOTE 6 Total: 22.499,00
Descrição: MONITOR CARDÍACO DE PRESSÃO ARTERIAL PANI + OXIMETRIA COM BATERIA.O monitor de pressão arterial não invasiva com medida de SpO^2. Destina-se a efetuar verificações pontuais ou monitoração das pressões sistólica, diastólica e média, frequência do pulso e da saturação do oxigênio como opcional. Permite a monitoração contínua do paciente com limites de alarmes, utilizado em hospitais, clínicas e durante o transporte terrestre de emergência. PANI Faixa de Medidas: Adulto: 10 a 250 mmHg; Neonato: 20 a 135 mmHg; Precisão: Igual ou superior SP-10AAMI; Norma para PANI (Norma AAMI: 5mmHg de erro médio, 8 mmHg de desvio padrão). A precisão da PANI é válida para a medida da pressão utilizando o braço. Tempo de medida: 30 a 50 seg típico. Max Adulto: 120 seg. Max Neonato: 90seg. Intervalo de medida: Automático, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 e 90min.Valor de insuflação: Adulto: 175 mmHg; Neonato: 125mmHg; Limite de Alarme (Adulto e Neonato): Alto: 15 a 285 mmHg e OFF (Passo 1mmHg); Baixo: 10 a 280 mmHg e OFF (Passo 1mmHg); Alarme por de fault: Sistólica: Alto: 200mmHg; Baixo:90mmHg; VDiastólica: Alto: 105mmHg; Baixo: 40mmHg; Média: Alto: 140mmHg; Baixo: 50mmHg SpO^2 Faixa de Medida: 0 a 100% (saturação); Precisão: 50 a 69% +- 2% - 70 a 100% +- 3%;Média:8pulsações;Bip de pulso: Volume ajustável ou OFF (oximetria) Limite de Alarme: Alto: 31 a 100% e OFF (passo 1%)Baixo: 30 a 99% e OFF (passo 1%)Alarme por default: Alto: desligado Baixo: 90Pulso Faixa de Medida: 30 a 180 bpm (PANI);30a254bpm (SpO^2); Precisão: 30 a 250 bpm +- 2% Média: 8 segundos (apenasSpO^2); Limite de alarme: Alto: 31 a 250 bpm e OFF (passo1bpm);Baixo: 30 a 249 bpm e OFF (passo 1 bpm); Alarme por default:Alto:150bpm; Baixo: 45bpm; Display e Indicadores: Display de LED para PANI, SpO^2 e pulso; Bargraph com escala logarítmica indicando a qualidade do sinal; Indicação de bateria fraca; Indicação de: Ligado, bateria carregando, bateria carregada, ligado à rede elétrica; Indicação de alarme de limites; Som 03 tipos de som: bip de pulso, alarmes e fim de medida de PANI; Controle digital e independente para alarmes e bip de pulso; Tendências Todos os parâmetros: sistólica,

Marcos Maises P Vieira

diastólica, média, pulso, SpO^2 e qualidade do sinal; 100 medidas com data e hora; Alimentação Rede Elétrica: 110ª 230 Vac 50/60Hz automático; Bateria: Chumbo-ácido 12Vdc Ah. Tempo aproximado de utilização após carga completa: 30 min. Tempo máximo para carga completa: 10h. Fonte externa:12V 0,5Vdc; Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. Alarmes. Alarme de limites alto e baixo para todos os parâmetros; Alarme de sensor desconectado; Alarme de falha de sensor; Alarme procurando por pulso por longo período (movimento); Alarme indicando erro de medidas de PANI; Especificações Ambientais Temperatura de operação: 0 a 60°C Temperatura de Armazenamento: - 40 a 70°C Umidade Relativa em operação: 15 a 95% (sem condensação);
Quantidade: 1 Valor Unit.: 22.499,00 Unidade: UNIDADE
Total Item: 22.499,00 Marca: EQUIPMED Modelo: SKU

CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA 25/05/2020 AS 16:00 ATÉ 29/05/2020 ÀS 08:00
ABERTURA DAS PROPOSTAS 29/05/2020 ÀS 08:00
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: ÀS 09:00 DO DIA 29/05/2020.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
ENTREGA: será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos serem executados após o recebimento da respectiva Ordem de Compra, junto á sede da Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na respectiva Ordem de Compra, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, de acordo com o edital
GARANTIA: De 12 (doze) meses, a contar da data de recebimento definitivo.
PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida pelo fornecedor.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil AG: 2755-3 C/C: 122392-5

DATA: 29/05/2020
Cirúrgica Parma Ltda- ME

Marcos Moises P Vieira

Marcos Moises Paulo Vieira
Sócio – Gerente
RG: 6412709-8/SESP-PR
CPF: 023.932.849-31
Cirúrgica Parma Ltda- ME

10.368.534/0001-29
CIRURGICA PARMA LTDA
Rua General Glicerio, 286
Vila Central - CEP 19.806-240
ASSIS - SP

PRÓ CARDÍACO
CENTRO CARDIOLÓGICO DE CASCAVEL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

394

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Instramed Indústria Médico Hospitalar, inscrita no CNPJ 90.909.631/0001-10, nos forneceu equipamento Desfibrilador Bifásico modelo APOLUS de sua linha de fabricação, dentro das normas comerciais, demonstrando capacidade e qualidade técnica de seu produto, cumprindo sempre com os prazo estabelecidos e não tendo qualquer fato que desabone sua conduta até o presente momento.

Cascavel, 01 de agosto de 2016.

PRÓ ANGIO
03.897.497/0001-80

Rua Vicente Machado, 1587 - 85812-150 - Cascavel - PR
45 3222-2475 - 3037-2057 - procardiaco@gmail.com

395

Marilia, 01 de Agosto de 2016.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR

Atestamos para os devidos fins e efeitos de direito que a **INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR**, estabelecida na Rua Beco José Paris nº 339, Bairro Sarandi, na Cidade de Porto Alegre -RS, inscrita no **CNPJ nº 90.909.631/0001-10** e **Inscrição Estadual nº 096/0642048** atuante no ramo de equipamentos médicos hospitalares, na transação comercial com **HOSPITAL ESPIRITA DE MARILIA-HEM, Inscrito no CNPJ- 52.050.010/0001-35**, Situado na Rua Dr. Joaquim de Abreu Sampaio Vidal, nº 470 Bairro Centro, cep 17.780-000 na cidade de Marilia/SP, forneceu os Equipamentos abaixo relacionados.

Afirmamos que a empresa mencionada atendeu as exigências estabelecidas em quantidade, qualidade e assistência técnica / manutenção exigidas durante o período de garantia, não havendo portanto nada que possa desaboná-la.

01 (Um) Cardioversor Cardiomax ECG+DESF Marca Instramed NF 12690.
08 (Oito) Desfibriladores externo Modelo ISIS-PRÓ Marca Instramed NF 16730.
01 (Um) Desfibrilador Modelo APOLUS Marca Instramed NF 16730.

Atenciosamente

Nome: Ricardo Almeida
CPF: 336 115 398 05

HOSPITAL ESPÍRITA DE MARÍLIA

396

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

Cartório Azevêdo Bastos Fundado em 1888

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **29/06/2018 16:25:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 765321

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **29/06/2019 15:55:35 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 75152906171019560683-1 a 75152906171019560683-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0232313cdcc58f5de747eda6ae81dec73f0c180483cb4e78e02f988160e89ee1a3c36d0c741ddabbdb44b35a4f
bebcb435d5f8c42db18c193673c0c5542a15fd

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

397

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Acreditado desde 1993

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 16.1764
Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00
Review ♦ Revisión:

Válido até: 30/01/2022
Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 30/01/2017
Issued ♦ Emitido:

Produto: ***Product:*** ***Producto:***	**APOLUS** **Desfibrilador Bifásico Apolus** **Características Técnicas: 100-265Vac, 50/60 Hz, 400VA** **Equipamento Classe I, Parte Aplicada do Tipo CF, IPX1** **Operação Contínua.**
Solicitante: ***Applicant:*** ***Solicitante:***	**INSTRAMED [illegible]DÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.** **Rua Beco [illegible]ris, 330 – Pavilhão 19 – Sarandi** **91140-3[illegible] Alegre – RS** **CNPJ: 9[illegible]001-10**
Fabricante: ***Manufacturer:*** ***Fabricante:***	**INST[illegible] MÉDICO HOSPITALAR LTDA.** **Ru[illegible] – Pavilhão 19 – Sarandi** **9[illegible] – RS** **[illegible]**
Fornecedor / Representante Legal: ***Supplier/Legal Representative:*** ***Proveedor/ Representante Legal:***	**[illegible]cável.**
Normas Técnicas / Regulamento: ***Standards/Regulation:*** ***Normas/Reglamento:***	**[illegible]R IEC 60601-1:2010 [illegible]: 2012, NBR IEC 60601-1-2:2010, [illegible]BR IEC 60601-1-6:2011 [illegible]601-2-4:2014.** **De acordo com as prescriçõ[illegible] 350 de 06 de Setembro de 2010 – INMETRO.** **Nos termos da Resolução – RD[illegible]1 de Junho de 2011 – ANVISA.**
Esquema de certificação: ***Certification Scheme:*** ***Esquema de certificación:***	**Modelo de Certificação 5, conform[illegible] 350 do INMETRO, com Ensaio de tipo, avaliação e [illegible] de Gestão da Qualidade do fabricante, [illegible]orias no fabricante e [illegible]ionado por avaliação e [illegible]**
Laboratório, Nº de [illegible] ensaios e data: ***Laboratory and [illegible] Nº / date:*** ***Laboratorio y [illegible] Prueba nº/fecha:***	**[illegible]ro de Ensaios de Conformidade Ltda. (IBEC)** **[illegible]tório Nº IBEC 160659 de 29/02/2016;** **Laboratórios Esp[illegible]aios (Labelo – PUCRS)** **[illegible]/2016 de 28/11/2016;** **Instramed Indústria Médico Hospitalar Ltda. (Documental)** **Relatório Nº Test Report IEC 60601-1-6 APOLUS (RP13.15) – Revisão 02.**
Relatório de Auditoria e data: ***Audit Report/ data:*** ***Informe de Auditoría/ fecha:***	**Auditoria realizada em 19/10/2016 PO -0672-16 Rev.01.**

Lester Amaral Junior
Gerente De Certificação - Medical

"Este documento é composto de 02 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes."

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/780278243911323954

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Endereço Escritório: Rua Libero Badaró, 293, 9º andar, Conjunto B, Centro, São Paulo – SP, CEP: 01009-000 / Endereço Sede: Av. Netuno, 32, 2º Andar, Sala 04, Alphaville, Santana de Parnaíba – SP, CEP: 06541-015
CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700 – www.tuv.com/br – 700-CE-039-01

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Acreditado desde 1993

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 16.1764
Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00
Review ♦ Revisión:

Válido até: 30/01/2022
Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 30/01/2017
Issued ♦ Emitido:

Notas:
Notes:
Anotación:

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e [illegible] certificados do INMETRO".
Este certific[illegible] está vinculado à proposta 0621615 aceita em 13/07/2016.

Lista de modelos:
Models List:
Lista de modelos:

Marca *Brand/Marca*	Modelo *Model/Modelo*	[illegible]	Código de Barras GTIN *GTIN Barcode/Código de Barras*
INSTRAMED	APOLUS	Caracte[illegible]plus [illegible]c, 50/60 Hz, 400VA[illegible]o Cla[illegible]plicada do [illegible]X1, Oper[illegible]a.	Não informado

Versão do Software avaliado:
Software Version evaluated:
Versión del software evaluado:
[illegible]109
[illegible]: 14

Versão do Manual do usuário e do [illegible] do Produto avaliado:
Version of User Manual and Pro[illegible] evaluated:
Versión del Manual de usuari[illegible] producto evaluado:
Versão R1.6-AEM1.1-2016-[illegible]

Lista de acessórios e pa[illegible]s em conjunto com o produto:
Accessories List and pa[illegible]ether with the produ[illegible]
Lista de accesorios y p[illegible]o conjunt[illegible]

[illegible]	Descrição
[illegible]	[illegible]de de Alimentação 3 pinos
[illegible]3	Guia Rápido
[illegible]01	Conjunto de Pás [illegible]
[illegible]277	CD [illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]erramento e equalização de potencial
[illegible]	[illegible]ação DC externo

Natureza das Revisões / Data
Nature of Reviews/Date ♦
Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:
Review/Revisión:
30/01/2017 – Recertificação. "Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº. ELM-14043 Revisão 02, primeira concessão em 13/02/2012".

Para confirmar sua autenticidade acesse https://tuv.3dds.digital/check/780278243911323954

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Endereço Escritório: Rua Libero Badaró, 293, – 9º Andar, Conjunto 8, Centro, São Paulo - SP CEP: 01009-000 /
Endereço Sede: Av. Netuno, 32 – 2º Andar, Sala 04, Alphaville, Santana de Parnaíba - SP, CEP: 06541-015
CNPJ: 01.950.467/0001-65 – Tel.: 55 11 3514.5700 – www.tuv.com/br – 700-CF-39-01

Ao
Município de Mucambo-Ceará,
Pregão Eletrônico n° 2205.01/2020

PROPOSTA DE PREÇOS

LICITANTE	INSTRAMED INDÚSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ	90.909.631/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	096/0642048
ENDEREÇO	Beco José Paris, 339 – Pavilhão nº. 18 e 19 - Bairro Sarandi.
CIDADE	Porto Alegre / RS - CEP 91140-310
TELEFONE	51 3073.8200 / 51 3073.8228
E-MAIL	licitacoes@instramed.com.br

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO:

Nome: Completo: Arthur Jorge de Almeida Moraes	
Cargo: Gerente Geral	
Estado Civil: Solteiro	
RG: 04.051.788-0	Órgão expedidor/UF: DETRAN /RJ
CPF: 511.125.237-15	
Endereço Completo: Rua Pampa, Nº 34 - Sarandi	
Cidade/Estado: Porto Alegre	CEP: 91150-103
Telefones: (51) 3073-8228	E-mail: licitacoes@instramed.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	VALOR UNITARIO R$	VALOR TOTAL R$
04	**01**	**UND**	**DESFIBRILADOR CONVENCIONAL** Desfibrilador Convencional com alça para transporte e sincronismo com monitor para cardioversão. Seleção de energia e funções com indicação visual. Possibilidade de uso de pás internas e externas adulto e infantil, com seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada. Teste das pás diretamente no equipamento tendo um retorno para o usuário diretamente no display. Tela de LCD para mostrar informações numéricas relacionadas ao processo de desfibrilação e indicador do estado da bateria. Forma de onda exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente. Aplicação de choque por meio de pás multifuncionais ou pás externas adulto/infantil. Escalas para desfibrilação adulto/externa: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules. Energia máxima limitada a 50J com as pás infantis e para desfibrilação interna. Operação simplificada por sequência padrão "1-2-3". Chave seletora tanto para ligá-lo e desligar o equipamento, assim como selecionar as escalas de energia e acionar o modo de teste funcional. Teclas de comando de Carga, Choque, Anula e Sinc (Sincronismo).Comando de carga por botão no painel frontal e por botão nas pás	**INSTRAMED / APOLUS**	**R$ 10.100,00**	**R$ 10.100,00**

			externas. Comando de choque no painel frontal e por botões nas pás externas. Anula carga por botão no painel frontal. Comando sincronizado acionado por botão SINC no painel frontal. Indicadores de carga por sinal sonoro de equipamento carregando, sinal sonoro de carga completa, LED nas pás externas e nível de carga indicada no display. Tempo de carga na energia máxima: < 6s com 90% a 100% da mínima tensão de rede especificada. < 6s com bateria a plena carga. < 13s a partir inicialização do equipamento. Tamanho das pás externas: Adulto = 10,3 cm x 8,5 cm - Área: 81,9 cm2. Infantil = 4,5 cm x 4,0 cm - Área: 18,0 cm2. Descarga interna automática: 30 segundos. Bateria interna recarregável: Tipo: NiMH, 14,4V DC 4,5 A/h. Duração (bateria com carga plena): mínimo de 140 choques em 360 joules ou um mínimo de 200 choques em 200 joules. Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 8 horas. Indicação do nível de bateria no display. Sincronismo: Circuito para sincronismo com MONITOR .Tempo descarga sincronizada: <60 ms após o pico da onda R.Tensão de saída máxima: 2000V.Corrente de saída máxima: 80A (25 Ω). Pás de desfibrilação: Adulto e infantil externas (inclusa).Adulto e infantil internas (opcional). Peso: Aparelho - 3,90 Kg. Pás externas - 0,85 Kg. Equipamento completo - 4,75 Kg. Elétrico: AC: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz.DC externo: 11 a 16 VDC. **ANVISA : 10242950011** **Acompanha :** Manual de instruções • Cabo de rede profissional (3 pinos) •Conjunto de pás para desfibrilação externa adulto e infantil.			
VALOR TOTAL DO ITEM 04 R$ 10.100,00 (DEZ MIL CEM REAIS)						

CONDIÇOES COMERCIAIS:

Validade da Proposta	60 (SESSENTA) dias
Condições de Pagamento	30 (trinta) dias
Prazo de Entrega	05 (CINCO) dias
Local de Entrega	Conforme edital
Garantia	12 (doze) meses
Impostos	Inclusos
Frete	Por Nossa Conta
Dados Bancários	Banco do Brasil S/A Agência n°. 1769-8 Conta Corrente n°. 56550-4

Declarações da proposta:

1. Declaramos sob as penas da lei, que temos pleno conhecimento dos termos constantes deste edital e das condições gerais e particulares do objeto desta Licitação;
2. Declaramos que no preço proposto encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete ate o destino, instalação e demais ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto;
3. Declaramos que o produto esta coberto por garantia On-site por um período não inferior a 12 (doze) meses a contar da instalação e funcionamento do equipamento e abrangerá a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças sem nenhum custo para o HOSPITAL a este título no período supra descrito, obrigando-se, ainda, independentemente de ser ou não fabricante, a efetuar, a qualquer tempo, substituição do equipamento que apresentar defeito de fabricação ou divergência com as especificações oferecidas, sem qualquer ônus para esta entidade;
4. Declaramos que todos os produtos ofertados são equipamentos novos, ou seja, entendido como tal, de primeira utilização, não possuem nenhum componente/peça/parte com características de ser recondicionado, re-manufaturado ou reaproveitado de outro equipamento e encontra-se em perfeitas condições de uso;

5. Declaramos que os produtos ofertados são equipamentos novos e de fabricação seriada da empresa, entendido como tal de primeira utilização e garantimos o fornecimento de peças, componentes e acessórios descontinuados por 05 (cinco) anos a contar da aquisição dos equipamentos;
6. Declaramos que possuímos pessoal técnico especializado para disponibilizar treinamento relativo à operacionalização do equipamento para toda a equipe técnica ou funcionário da que for operar os equipamentos e treinamento técnico, auxílio na instalação e treinamento de manutenção, manuseio dos mesmos e demais serviços inerentes à atividade durante a garantia do equipamento de acordo com a disponibilidade do setor para capacitá-los quanto ao uso correto e seguro dos equipamentos, no local de suas respectivas instalações sem qualquer ônus para a Instituição;
7. Declaramos que a assistência técnica abaixo esta apta para realizar analise, calibração, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, objeto desta Cotação, será prestada, preferencialmente, no ambiente da entidade adquirente ou nos locais por ela indicados, por funcionários especializados para solução dos problemas técnicos, incluindo troca de peças, depois de recebida a chamada ou tomando conhecimento do problema existente durante a vigência da garantia sem ônus algum para a vossa Instituição, conforme as informações abaixo:

ASSITÊNCIA TÉCNICA

[redacted]	09.534.589/0001-82
	63684381
	Rua Thomas Edson, nº 1345/77 – Parangaba Fortaleza/CE CEP 60740-745
	http://www.biofors.com.br/ FONE (85) 32322545

Porto Alegre, 29 de Maio de 2020.

90.909.631/0001-10
INSTRAMED
Indústria Médico Hospitalar Ltda
Beco José Paris, 339/19.
Sarandi - CEP: 91140-310
PORTO ALEGRE - RS

ARTHUR JORGE DE ALMEIDA MORAES:51112523715

Assinado de forma digital por ARTHUR JORGE DE ALMEIDA MORAES:51112523715
Dados: 2020.05.29 11:18:20 -03'00'

INSTRAMED – INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
ARTHUR JORGE DE ALMEIDA MORAES
Representante Legal
RG: 212.114.5714 SSP/RS
CPF: 511.125.237-15

402

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa	Instramed Industria Médico Hospitalar LTDA		
CNPJ	90.909.631/0001-10	**Autorização**	1.02.429-5
Produto	DESFRIBILADOR BIFÁSICO APOLUS		

Modelo Produto Médico
APOLUS

Nome Técnico	Desfibrilador
Registro	10242950011
Processo	25351.119049/2012-25
Origem do Produto	• FABRICANTE: Instramed Industria Médico Hospitalar LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	09/07/2027

Voltar

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.391, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016

O (A) Gerente-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 2.198, de 30 de novembro de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e ainda amparado pela Resolução nº 346, de 16 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento de empresa prestadora de serviço de Armazenagem em Recintos Alfandegados, em conformidade com o disposto no anexo.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIA BAPTISTA DA NOBREGA MOREIRA

ANEXO

MATRIZ
EMPRESA: BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A.
AUTORIZ/MS: 9.07806-4
CNPJ: 92.721.232/0001-57
PROCESSO Nº. 25751.323239/2007-78
ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas nº 8201
BAIRRO: São Luiz
MUNICÍPIO: Canoas
UF: RS
CEP: 92010-011
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviço de armazenagem de alimentos e matérias-primas que os integrem em Recinto Alfandegado.
MATRIZ
EMPRESA: BANRISUL ARMAZÉNS GERAIS S.A.
AUTORIZ/MS: 9.07807-8
CNPJ: 92.721.232/0001-57
PROCESSO Nº. 25751.618285/2012-16
ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas nº 8201
BAIRRO: São Luiz
MUNICÍPIO: Canoas
UF: RS
CEP: 92010-011
ÁREA: PAF
ATIVIDADE: Prestação de serviço de armazenagem de medicamentos, matérias-primas, insumos farmacêuticos em Recinto Alfandegado.

DIRETORIA DE REGULAÇÃO SANITÁRIA
GERÊNCIA-GERAL DE REGULAMENTAÇÃO E BOAS PRÁTICAS REGULATÓRIAS
GERÊNCIA-GERAL DE TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE

RESOLUÇÃO- RE Nº 3.369, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387, de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

[redacted]

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA AUTORIZAÇÃO
NOME TÉCNICO NUMERO DO PROCESSO
NOME COMERCIAL
LOCAL DE FABRICAÇÃO
MODELO(s) DO PRODUTO
CLASSE REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES)

ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA 8.01465-0
FIO GUIA CARDIOVASCULAR 25351.199515/2007-83
HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT GUIDE WIRE
FABRICANTE : ABBOTT VASCULAR - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
1001780; 1001780J; 1001782; 1001782J; 1001780-HC; 1001780J-HC; 1001782-HC; 1001782J-HC; 1005107; 1005107J; 1005107-HC; 1005107J-HC.
CLASSE : IV 80146501479
8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família

Acurate Indústria e Comércio Ltda 8.10421-8
Protese Valvular Cardiaca 25351.857060/2016-11
bioprotese aortica acurate
FABRICANTE : Acurate Indústria e Comércio Ltda - BRASIL
Sistema de Liberação Transfemoral ACURATE TF: ACU-SV23-002
Bioprótese Aórtica ACURATE neo™ Tamanho S; ACU-SV25-002
Bioprótese Aórtica ACURATE neo™ Tamanho M; ACU-SV27-002
Bioprótese Aórtica ACURATE neo™ Tamanho L
CLASSE : IV 81042180001
8419 - MATERIAL - Retificação de Publicação no D.O.U - Correção pela ANVISA

ADEM DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP 8.03327-6
Sistema de Laser Para Terapia 25351.331913/2010-13
LASER PARA TERAPIA ILIPO
FABRICANTE : CHROMOGENEX TECHNOLOGIES LTD. - REINO UNIDO
ILIPO
CLASSE : II 80332760006
8062 - EQUIPAMENTO - Cancelamento de Registro ou Cadastro

ALCARD INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA 8.04833-0
Valvula Cardiaca 25351.477968/2015-05
Válvula Biológica Aórtica de Pericárdio Bovino Mitroflow
FABRICANTE : LIVANOVA CANADA CORP - CANADÁ
DLA19; DLA21; DLA23; DLA25; DLA27; DLA29; CNA19; CNA21; CNA23; CNA25; CNA27; CNA29.
CLASSE : IV 80483300016
80005 - MATERIAL - Alteração da razão social da empresa estrangeira fabricante em registro

---

ALERE S/A 1.00717-7
DENGUE 25351.134452/2013-33
Alere Dengue - NS1
FABRICANTE : STANDARD DIAGNOSTICS INC - CORÉIA DO SUL
1 teste
10 testes
100 testes
15 testes
20 testes
25 testes
30 testes
40 testes
5 testes
50 testes
CLASSE : III 10071770694
8444 - IVD - Alteração das informações do dossiê técnico de produtos registrados (classes III ou IV)
DENGUE 25351.135424/2013-33
ALERE DENGUE DUO - NS1, IgM E IgG
FABRICANTE : STANDARD DIAGNOSTICS - CORÉIA DO SUL
Embalagem para 1 teste: Dispositivo de teste Dengue NS1 e IgG/IgM 1 unidade/ Tampão diluente 1x5mL
Embalagem para 10 testes: Dispositivo de teste Dengue NS1 e IgG/IgM 10 unidades/ Tampão diluente 1x5mL
Embalagem para 100 testes: Dispositivo de teste Dengue NS1 e IgG/IgM 100 unidades/ Tampão diluente 10x5mL
Embalagem para 20 testes: Dispositivo de teste Dengue NS1 e IgG/IgM 20 unidades/ Tampão diluente 2x5mL
Embalagem para 25 testes: Dispositivo de teste Dengue NS1 e IgG/IgM 25 unidades/ Tampão diluente 3x5mL
Embalagem para 30 testes: Dispositivo de teste Dengue NS1 e IgG/IgM 30 unidades/ Tampão diluente 3x5mL
Embalagem para 40 testes: Dispositivo de teste Dengue NS1 e IgG/IgM 40 unidades/ Tampão diluente 4x5mL
Embalagem para 5 testes: Dispositivo de teste Dengue NS1 e IgG/IgM 5 unidades/ Tampão diluente 1x5mL
Embalagem para 50 testes: Dispositivo de teste Dengue NS1 e IgG/IgM 50 unidades/ Tampão diluente 5x5mL
CLASSE : III 10071770730
8444 - IVD - Alteração das informações do dossiê técnico de produtos registrados (classes III ou IV)

ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA 8.01436-0
Solucao para Preenchimento Intradermico 25351.492839/2007-98
JUVÉDERM HYDRATE
FABRICANTE : ALLERGAN - FRANÇA
JUVÉDERM HYDRATE
CLASSE : IV 80143600081
80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros

---

ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 8.01885-1
Equipos 25351.500336/2008-84
EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL DIALINE
FABRICANTE : ALLMED PRONEFRO PT, S.A. - PORTUGAL
EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL MACROGOTAS
CLASSE : II 80188510010
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Equipos 25351.473778/2015-09
KIT PARA HEMODIÁLISE 6MM COMPLETA_42BP (Conjunto Descartável de Circulação Assistida)
FABRICANTE : ALLMED PRONEFRO PT, S.A. - PORTUGAL
LINHA VENOSA; LINHA ARTERIAL
CLASSE : II 80188510021
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Equipos 25351.473800/2015-61
kit para hemodiálise 8mm completa_314BP (Conjunto Descartável de Circulação Assistida)
FABRICANTE : ALLMED PRONEFRO PT, S.A. - PORTUGAL
LINHA VENOSA LINHA ARTERIAL
CLASSE : II 80188510023
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

AMETECH TRADING LTDA 1.03340-2
Instrumental para Laparoscopia 25351.341604/2006-58
SISTEMA DE TESOURA LAPAROSCOPICA
FABRICANTE : APPLIED MEDICAL RESOURCES CORP. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
CB010
CB030
CB040
CB050; CB060
CB101
CLASSE : III 10334020032
8058 - EQUIPAMENTO - Revalidação de Registro de Sistema/Família de Equipamentos de Médio e Pequeno Porte

---

ANTEIS DO BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 8.09531-8
Solucao para Preenchimento Intradermico 25351.165994/2015-11
Belotero Balance
FABRICANTE : ANTEIS SA - SUÍÇA
Apresentação: 1 ou 5 unidades do produto (seringas de vidro com 2 ou 10 agulhas). A seringa pode conter 0,6 ou 1,0 ml do produto.
CLASSE : IV 80953180002
80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros
80004 - MATERIAL - Alteração das condições de armazenamento e transporte do produto em registro
Solucao para Preenchimento Intradermico 25351.165958/2015-44
Belotero Volume
FABRICANTE : ANTEIS SA - SUÍÇA
Belotero Volume 2x 1ml (caixa contendo 2 seringas de 1ml + 2 agulhas 27G ½', 2 agulhas 30G ½" + 2 cânulas de 27G 37mm).
CLASSE : IV 80953180003
80003 - MATERIAL - Alteração das indicações de uso, contraindicações, efeitos adversos, advertências ou precauções em registros
8042 - MATERIAL - Alteração da apresentação comercial em registro

---

anthogyr do brasil importação exportação comercio de produtos odontológicos ltda8.06324-4
Brocas Cirurgicas Odontologicas 25351.996321/2016-35
BROCAS EURO-POST
FABRICANTE : ANTHOGYR - FRANÇA
5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5609_T, 5610_T, 5611_T, 5612_T, 5613_T, 5614_T, 5615_T, 5616_T
CLASSE : I 80632440016
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. 1.03490-0
Grampeador Cirurgico 25351.232900/2004-05
GRAMPEADOR TA DST E GRAMPO PARA GRAMPEADOR TA DST AUTO SUTURE
FABRICANTE : COVIDIEN IIc - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
TA3035L, TA3035S, TA3048L, TA3048S, TA30V3L, TA30V3S, TA4535L, TA4535S, TA4548L, TA4548S, TA6035L, TA6035S, TA6048L, TA6048S, TA9035L, TA9035S, TA9048L, TA9048S
CLASSE : III 10349000235
8040 - MATERIAL - Alteração do nome comercial e/ou denominação do código/modelo comercial do produto em registro
Telas 25351.017035/2007-11
TELA DE POLIÉSTER MULTIFILAMENTAR PARIETEX
FABRICANTE : SOFRADIM PRODUCTION - FRANÇA
TEC 1309; TECR 1510; TECT 1612 AL; TEC 1410 DP; TECR 1510 AR; TECT 1612 AR; TEC 1410 DPY2; TECR 1510 AL; TECT 1612 AFL; TEC 1410 P; TECR 1515; TECT 1612 AFR; TEC 1410 P5; TECR 3030; TET 1208 DL; TEC 1510; TECRT 6; TET 1208 DR; TEC 1515; TECRT 8; TET 1309; TEC 2020; TECT 1309 AL ; TET 1309 D; TEC 3030; TECT 1510 ADP2iL; TET 1409 DL; TECG 3004; TECT 1510 ADP2iR; TET 1409 DR; TEC GK03; TECT 1510 AL; TET 1510; TEC GK04; TECT 1510 AR; TET 1515; TEC GK05; TECT 1510 ADPL; TET 2020; TEC GK06; TECT 1510 ADPR; TET 3030; TECL GK01; TECT 1510 ADP2L; TECR 1410DP2; TECT 1510 ADP2R.
CLASSE : IV 10349000273
8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família
Grampo (Clips/Clamps) 25351.162858/2011-85
CARGA PARA GRAMPEADOR ENDO GIA UNIVERSAL COM TECNOLOGIA TRI-STAPLE
FABRICANTE : COVIDIEN IIc - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
EGIA30AVM, EGIA30AMT, EGIA30CTAVM, EGIA45CTAVM, EGIA45CTAV, EGIA45AMT, EGIA45AV, EGIA45AVM, EGIA45AXT, EGIA60AXT, EGIA60CTAMT, EGIA60CTAVM, EGIA60AMT, EGIA60AVM
CLASSE : III 10349000296
8040 - MATERIAL - Alteração do nome comercial e/ou denominação do código/modelo comercial do produto em registro
STENT PARA ARTÉRIAS PERIFÉRICAS 25351.479944/2014-95
STENT PERIFÉRICO AUTOEXPANSÍVEL PROTÉGÉ RX GPS
FABRICANTE : EV3. INC - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
SEPX-8-6-30-135; SEPX-8-6-40-135; SEPX-10-7-30-135; SEPX-10-7-40-135; SEPX-6-20-135;SEPX-6-30-135; SEPX-6-40-135; SEPX-6-60-135; SEPX-7-20-135; SEPX-7-30-135; SEPX-7-40-135;SEPX-7-60-135; SEPX-8-20-135; SEPX-8-30-135; SEPX-8-40-135; SEPX-8-60-135; SEPX-9-20-135;SEPX-9-30-135; SEPX-9-40-135; SEPX-

ósseo Ø7,0 x 125mm encaixe S; PA35.90.70.125.A- Fresa de alto desbaste ósseo Ø7,0 x 125mm encaixe A; PA35.90.70.125.L- Fresa de alto desbaste ósseo Ø7,0 x 125mm encaixe L; PA35.90.70.125.D- Fresa de alto desbaste ósseo Ø7,0 x 125mm encaixe D; PA35.90.70.125.U- Fresa de alto desbaste ósseo Ø7,0 x 125mm encaixe U; Fresa Laminada para Acabamento PA35.100.50.45.R- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 45mm encaixe R; PA35.100.50.45.H- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 45mm encaixe H; PA35.100.50.45.T- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 45mm encaixe T; PA35.100.50.45.J- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 45mm encaixe J; PA35.100.50.45.O- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 45mm encaixe O; PA35.100.50.45.S- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 45mm encaixe S; PA35.100.50.45.A- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 45mm encaixe A; PA35.100.50.45.L- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 45mm encaixe L; PA35.100.50.45.D- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 45mm encaixe D; PA35.100.50.45.U- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 45mm encaixe U; PA35.100.50.55.R- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 55mm encaixe R; PA35.100.50.55.H- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 55mm encaixe H; PA35.100.50.55.T- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 55mm encaixe T; PA35.100.50.55.J- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 55mm encaixe J; PA35.100.50.55.O- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 55mm encaixe O; PA35.100.50.55.S- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 55mm encaixe S; PA35.100.50.55.A- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 55mm encaixe A; PA35.100.50.55.L- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 55mm encaixe L; PA35.100.50.55.D- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 55mm encaixe D; PA35.100.50.55.U- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 55mm encaixe U; PA35.100.50.70.R- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 70mm encaixe R; PA35.100.50.70.H- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 70mm encaixe H; PA35.100.50.70.T- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 70mm encaixe T; PA35.100.50.70.J- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 70mm encaixe J; PA35.100.50.70.O- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 70mm encaixe O; PA35.100.50.70.S- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 70mm encaixe S; PA35.100.50.70.A- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 70mm encaixe A; PA35.100.50.70.L- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 70mm encaixe L; PA35.100.50.70.D- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 70mm encaixe D; PA35.100.50.70.U- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 70mm encaixe U; PA35.100.50.95.R- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 95mm encaixe R; PA35.100.50.95.H- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 95mm encaixe H; PA35.100.50.95.T- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 95mm encaixe T; PA35.100.50.95.J- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 95mm encaixe J; PA35.100.50.95.O- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 95mm encaixe O; PA35.100.50.95.S- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 95mm encaixe S; PA35.100.50.95.A- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 95mm encaixe A; PA35.100.50.95.L- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 95mm encaixe L; PA35.100.50.95.D- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 95mm encaixe D; PA35.100.50.95.U- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 95mm encaixe U; PA35.100.50.125.R- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 125mm encaixe R; PA35.100.50.125.H- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 125mm encaixe H; PA35.100.50.125.T- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 125mm encaixe T; PA35.100.50.125.J- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 125mm encaixe J; PA35.100.50.125.O- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 125mm encaixe O; PA35.100.50.125.S- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 125mm encaixe S; PA35.100.50.125.A- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 125mm encaixe A; PA35.100.50.125.L- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 125mm encaixe L; PA35.100.50.125.D- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 125mm encaixe D; PA35.100.50.125.U- Fresa Laminada para Acabamento Ø5,0 x 125mm encaixe U; PA35.100.70.45.R- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 45mm encaixe R; PA35.100.70.45.H- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 45mm encaixe H; PA35.100.70.45.T- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 45mm encaixe T; PA35.100.70.45.J- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 45mm encaixe J; PA35.100.70.45.O- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 45mm encaixe O; PA35.100.70.45.S- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 45mm encaixe S; PA35.100.70.45.A- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 45mm encaixe A; PA35.100.70.45.L- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 45mm encaixe L; PA35.100.70.45.D- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 45mm encaixe D; PA35.100.70.45.U- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 45mm encaixe U; PA35.100.70.55.R- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 55mm encaixe R; PA35.100.70.55.H- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 55mm encaixe H; PA35.100.70.55.T- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 55mm encaixe T; PA35.100.70.55.J- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 55mm encaixe J; PA35.100.70.55.O- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 55mm encaixe O; PA35.100.70.55.S- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 55mm encaixe S; PA35.100.70.55.A- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 55mm encaixe A; PA35.100.70.55.L- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 55mm encaixe L; PA35.100.70.55.D- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 55mm encaixe D; PA35.100.70.55.U- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 55mm encaixe U; PA35.100.70.70.R- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 70mm encaixe R; PA35.100.70.70.H- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 70mm encaixe H; PA35.100.70.70.T- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 70mm encaixe T; PA35.100.70.70.J- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 70mm encaixe J; PA35.100.70.70.O- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 70mm encaixe O; PA35.100.70.70.S- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 70mm encaixe S; PA35.100.70.70.A- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 70mm encaixe A; PA35.100.70.70.L- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 70mm encaixe L; PA35.100.70.70.D- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 70mm encaixe D; PA35.100.70.70.U- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 70mm encaixe U; PA35.100.70.95.R- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 95mm encaixe R; PA35.100.70.95.H- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 95mm encaixe H; PA35.100.70.95.T- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 95mm encaixe T; PA35.100.70.95.J- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 95mm encaixe J; PA35.100.70.95.O- Fresa Laminada para Acabamento Ø7,0 x 95mm encaixe O;>
CLASSE : II 80521210024
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Instrumentos cirúrgicos 25351.507945/2015-21
Lâmina Percutânea Descartável - Implanfix
FABRICANTE : IMPLANFIX MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA. - ME - BRASIL
PA29.012
CLASSE : II 80521219001
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

IMPLANTEC MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 8.00465-3
Pino e fio rígidos não absorvíveis 25351.422434/2005-21
PINO E FIOS ÓSSEOS
FABRICANTE : IMPLANTEC MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL
DISTRIBUIDOR : IMPLANTEC MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - BRASIL
FIO (3203) (3206) (4131) (4132) (2161) (2162)
PINO (2300) (2301) (2302) (2303) (2304) (2305) (2306) (2307) (2308) (2309) (2310) (2311) (2312)(2313) (2314) (2315) (2316) (2317) (2318) (2319) (2320) (2321) (2322) (2323) (2324) (2325)(2326) (2327) (2328) (2329)
CLASSE : III 80046530007
8032 - MATERIAL - Revalidação de Registro de Família

IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA 1.03034-6
HEMOGLOBINA GLICADA 25351.533048/2010-87
HbA1c %
FABRICANTE : IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA - BRASIL
100 testes: RGT1 1 x 75 mL; RGT2 1 x 25 mL; LYS 2 x 250 mL> 100 testes: RGT1 3 x 25 mL; RGT2 2 x 12,5 mL; LYS 2 x 250 mL> 150 testes: RGT1 1 x 112,5 mL; RGT2 1 x 37,5 mL; LYS 2 x 375 mL> 20 testes: RGT1 1 x 15 mL; RGT2 1 x 5 mL; LYS 1 x 100 mL> 200 testes: RGT1 1 x 150 mL; RGT2 1 x 50 mL; LYS 2 x 500 mL> 200 testes: RGT1 2 x 75 mL; RGT2 2 x 25 mL; LYS 2 x 500 mL> 200 testes: RGT1 3 x 50 mL; RGT2 2 x 25 mL; LYS 2 x 1000 mL> 250 testes: RGT1 1 x 187,5 mL; RGT2 1 x 62,5 mL; LYS 2 x 625 mL> 300 testes: RGT1 1 x 225 mL; RGT2 1 x 75 mL; LYS 2 x 750 mL> 300 testes: RGT1 3 x 75 mL; RGT2 3 x 25 mL; LYS 2 x 750 mL> 350 testes: RGT1 1 x 262,5 mL; RGT2 1 x 87,5 mL; LYS 2 x 875 mL> 40 testes: RGT1 1 x 30 mL; RGT2 1 x 10 mL; LYS 2 x 100 mL> 40 testes: RGT1 2 x 15 mL; RGT2 2 x 5 mL; LYS 2 x 100 mL> 400 testes: RGT1 1 x 300 mL; RGT2 1 x 100 mL; LYS 2 x 1000 mL> 400 testes: RGT1 3 x 100 mL; RGT2 2 x 50 mL; LYS 2 x 1000 mL> 450 testes: RGT1 1 x 337,5 mL; RGT2 1 x 112,5 mL; LYS 3 x 750 mL> 50 testes: RGT1 1 x 37,5 mL; RGT2 1 x 12,5 mL ; LYS 2 x 125 mL> 50 testes: RGT1 1 x 37,5 mL; RGT2 1 x 12,5 mL; LYS 1 x 250 mL> 500 testes: RGT1 1 x 375 mL; RGT2 1 x 125 mL; LYS 2 x 1250 mL> 500 testes: RGT1 3 x 125 mL; RGT2 1 x 125 mL; LYS 4 x 625 mL> 60 testes: RGT1 1 x 45 mL; RGT2 1 x 15 mL; LYS 2 x 150 mL> 60 testes: RGT1 3 x 15 mL; RGT2 3 x 5 mL; LYS 2 x 150 mL> 70 testes: RGT1 1 x 52,5 mL; RGT2 1 x 17,5 mL; LYS 1 x 350 mL> 80 testes: RGT1 1 x 60 mL; RGT2 1 x 20 mL; LYS 2 x 200 mL> 80 testes: RGT1 2 x 30 mL; RGT2 2 x 10 mL; LYS 2 x 200 mL> 90 testes: RGT1 1 x 67,5 mL; RGT2 1 x 22,5 mL; LYS 2 x 225 mL>
CLASSE : II 10303460349
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados (classes I ou II)

[redacted]

ITS MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 8.04545-5
Conectores e Conexoes 25351.109638/2014-78
Mangueira ITS-MC
FABRICANTE : ITS MATERIAL CIRÚRGICO LTDA - BRASIL
MicroAire)> Microaire)> 19-503 Mangueira universal 3m (A.O./ITS-MC)> 19-504 Mangueira universal 4m (A.O./ITS-MC) 19-505 Mangueira universal 5m (A.O./ITS-MC)> 19-513 Mangueira universal 3m (A.O./ITS-MC) 19-514 Mangueira universal 4m (A.O./ITS-MC)> 19-515 Mangueira universal 5m (A.O./ITS-MC)> 19-523 Mangueira universal 3m (A.O./A.O.)> 19-524 Mangueira universal 4m (A.O./A.O.)> 19-525 Mangueira universal 5m (A.O./A.O.)> 19-533 Mangueira universal 3m (A.O./de Soutter)> 19-534 Mangueira universal 4m (A.O./de Soutter)> 19-535 Mangueira universal 5m (A.O./de Soutter)> 19-543 Mangueira universal 3m (A.O./Aesculap)> 19-544 Mangueira universal 4m (A.O./Aesculap)> 19-545 Mangueira universal 5m (A.O./Aesculap)> 19-553 Mangueira universal 3m (A.O./Hall> 19-554 Mangueira universal 4m (A.O./Hall> 19-555 Mangueira universal 5m (A.O./Hall> 19-563 Mangueira universal 3m (A.O./Triton)> 19-564 Mangueira universal 4m (A.O./Triton)> 19-565 Mangueira universal 5m (A.O./Triton)> 20-503 Mangueira universal 3m (Aesculap/ITS-MC Micro)> 20-504 Mangueira universal 4m (Aesculap/ITS-MC Micro)> 20-505 Mangueira universal 5m (Aesculap/ITS-MC Micro)> 20-513 Mangueira universal 3m (Aesculap/ITS-MC)> 20-514 Mangueira universal 4m (Aesculap/ITS-MC)> 20-515 Mangueira universal 5m (Aesculap/ITS-MC)> 20-523 Mangueira universal 3m (Aesculap/A.O.)> 20-524 Mangueira universal 4m (Aesculap/A.O.)> 20-525 Mangueira universal 5m (Aesculap/A.O.)> 20-533 Mangueira universal 3m (Aesculap/De Soutter)> 20-534 Mangueira universal 4m (Aesculap/De Soutter)> 20-535 Mangueira universal 5m (Aesculap/De Soutter)> 20-543 Mangueira universal 3m (Aesculap/Aesculap)> 20-544 Mangueira universal 4m (Aesculap/Aesculap)> 20-545 Mangueira universal 5m (Aesculap/Aesculap)> 20-553 Mangueira universal 3m (Aesculap/Hall> 20-554 Mangueira universal 4m (Aesculap /Hall> 20-555 Mangueira universal 5m (Aesculap/Hall> 20-563 Mangueira universal 3m (Aesculap/Triton)> 20-564 Mangueira universal 4m (Aesculap/Triton)> 20-565 Mangueira universal 5m (Aesculap/Triton)> 21-503 Mangueira universal 3m> 21-504 Mangueira universal 4m> 21-505 Mangueira universal 5m> 21-514 Mangueira universal 4m> 21-515 Mangueira universal 5m> 21-516 Mangueira universal 3m> 21-523 Mangueira universal 3m (ITS-MC /A.O.)> 21-524 Mangueira universal 4m (ITS-MC /A.O.)> 21-525 Mangueira universal 5m (ITS-MC /A.O.)> 21-533 Mangueira universal 3m (ITS-MC /de Soutter)> 21-534 Mangueira universal 4m (ITS-MC /de Soutter)> 21-535 Mangueira universal 5m (ITS-MC /de Soutter)> 21-543 Mangueira universal 3m (ITS-MC /Aesculap)> 21-544 Mangueira universal 4m (ITS-MC /Aesculap)> 21-545 Mangueira universal 5m (ITS-MC /Aesculap)> 21-553 Mangueira universal 3m (ITS-MC /Hall> 21-554 Mangueira universal 4m (ITS-MC /Hall> 21-555 Mangueira universal 5m (ITS-MC /Hall> 21-563 Mangueira universal 3m (ITS-MC/Triton)> 21-564 Mangueira universal 4m (ITS-MC/Triton)> 21-565 Mangueira universal 5m (ITS-MC/Triton)> 28-300 Mangueira de adução 5m (ITS-MC/ar comprimido e nitrogênio)> 28-301 Mangueira de adução 10m (ITS-MC/ar comprimido e nitrogênio)> 28-302 Mangueira de adução 15m (ITS-MC/ar comprimido e nitrogênio)> 28-310 Mangueira de adução 5m (Valvulado medicinal/ar comprimido)> 28-311 Mangueira de adução 10m (Valvulado medicinal/ar comprimido)> 28-312 Mangueira de adução 15m (Valvulado medicinal/ar comprimido)> 28-315 Mangueira de adução 5m (Valvulado medicinal/nitrogênio)> 28-316 Mangueira de adução 10m (Valvulado medicinal/nitrogênio)> 28-317 Mangueira de adução 15m (Valvulado medicinal/nitrogênio)> 28-320 Mangueira de adução 5m (A.O./ar comprimido e nitrogênio)> 28-321 Mangueira de adução 10m (A.O./ar comprimido e nitrogênio)> 28-322 Mangueira de adução 15m (A.O./ar comprimido e nitrogênio)>
CLASSE : II 80454550006
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de Informações de Cadastro

JGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S/A 1.03444-2
Instrumentos de Uso Odontologico 25351.043314/2016-11
INSTRUMENTAIS NÃO-ARTICULADOS NÃO-CORTANTES EM TITÂNIO STRAUMANN
FABRICANTE : INSTITUT STRAUMANN AG - SUÍÇA
025.0044 - Componente adicional do Indicador de Distância, para BLT 2,9mm; 026.0058 - SC Indicador de posição, oval, L 10mm; 031.102 - ND Indicador de Posição, 2,2 mm, altura 4mm, comprimento 8mm; 031.103 - ND Indicador de Posição, 2,8 mm, altura 4mm, comprimento 8mm; 031.112 - ND Indicador de Posição, 2,2 mm, altura 5.5 mm, comprimento 8mm; 031.113 - ND Indicador de Posição, 2,8 mm, altura 5.5 mm, comprimento 8mm; 031.123 - RD Indicador de Posição, 2,2 mm, altura 4mm, comprimento 8mm; 031.125 - RD Indicador de Posição, 3,5 mm, altura 4mm, comprimento 8mm; 031.143 - RD Indicador de Posição, 2,2 mm, altura 5.5 mm, comprimento 8mm; 031.145 - RD Indicador de Posição, 3,5 mm, altura 5.5 mm, comprimento 8mm; 046.703 - Pino de Alinhamento 2,2mm, comprimento 27 mm; 046.704 - BLT Medidor de profundidade, com indicador de distância, 2.2/2.8mm, comprimento 27mm; 046.705 - BLT Medidor de profundidade, 2.8mm, comprimento 27mm; 046.706 - BLT Medidor de profundidade, 3.5mm, comprimento 27mm; 046.707 - BLT Medidor de profundidade, 4.2 mm, comprimento 27mm
CLASSE : I 10344420160
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA8.01459-0
Grampeador Cirurgico 25000.024115/99-70
GRAMPEADOR DE PELE PROXIMATE*
FABRICANTE : ETHICON ENDO-SURGERY LLC - PORTO RICO
Proximate RH; Proximate Plus MD
CLASSE : II 10132590494
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em Cadastro
Eletrodo Descartavel 25351.051224/2004-62
ELETRODO VAPR
FABRICANTE : DEPUY MITEK, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
225028 Eletrodo de sucção VAPR Tripolar 90° com peça de mão integrada.
225029 Eletrodo de sucção VAPR Artic ponta Domo com peça de mão integrada
225030 Eletrodo de sucção VAPR Artic ponta Cinsel com peça de mão integrada
225252-Eletrodo TC VAPR / 225301-VAPR Eletrodo de efeito lateral / 225302-VAPR Eletrodo de efeito lateral angulado / 225303-VAPR Eletrodo de efeito anterior / 225304-VAPR Eletrodo de efeito anterior angulado / 225305-VAPR Eletrodo de Gancho de 90 graus / 225402-Bainha de aspiração VAPR 3,5 mm / 225401-Bainha de aspiração

apolus

DESFIBRILADOR BIFÁSICO

INSTRAMED

apolus

DESFIBRILADOR BIFÁSICO

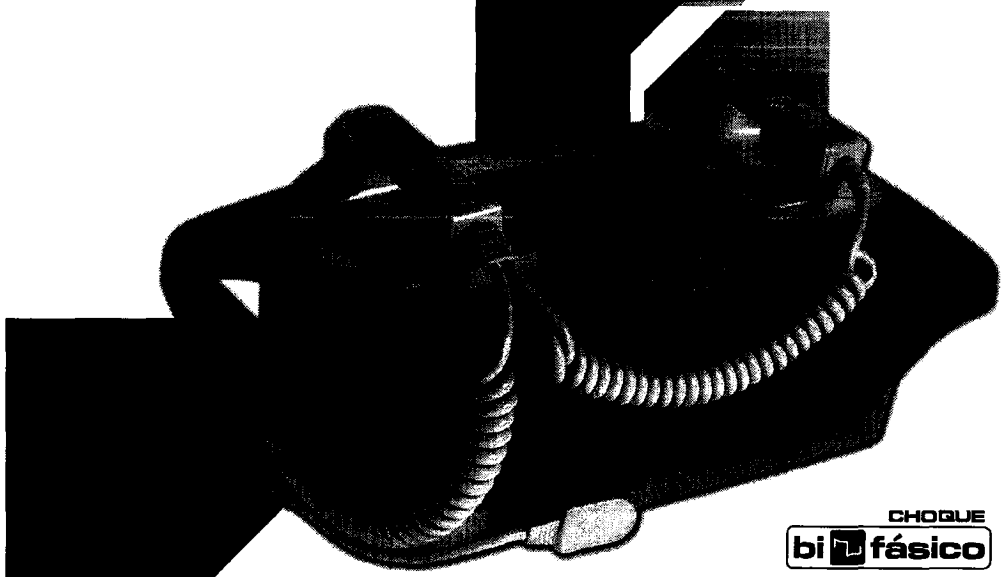

CHOQUE bifásico

- Pás multifuncionais adulto e infantil integradas.
- Indicador de carga pronta e contato com o paciente nas pás.
- Pás opcionais para desfibrilação interna (adulto e infantil).
- Conexão para sincronismo com monitor cardíaco externo (cardioversão).

O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO EM UM EQUIPAMENTO VOLTADO PARA FUNÇÃO BÁSICA DE DESFIBRILAÇÃO, SEM ABRIR MÃO DA SEGURANÇA DE UM FABRICANTE CONSAGRADO.

VERSÁTIL:

Leve e robusto, apresenta base baixa e larga, que facilita o uso e permite a operação na horizontal ou fixação na vertical.

Grandes alças em ambos os lados e desenho sem cantos vivos, projetados para o transporte de emergência.

FÁCIL DE OPERAR:

Principais funções concentradas em apenas um botão.

Operação no padrão 1, 2, 3 - utiliza o mesmo layout de comandos da linha CardioMax facilitando o uso por profissionais já familiarizados com equipamentos Instramed, resultando em menos investimento e tempo de treinamento.

INTELIGENTE:

Infocenter - por meio do display LCD o usuário recebe informações (em português) sobre a operação do equipamento e alertas do teste funcional.

AVANÇADO:

Energia bifásica entregue de até 360J, limitada eletronicamente em 50J quando utilizado com pás infantis.

Inicialização instantânea.

Pronto para choque em menos de 6 segundos.

SEGURO:

Conte com a segurança e tecnologia de uma marca que há mais de 25 anos atende ao mercado médico profissional.

Projeto e fabricação nacional com garantia de assistência de fábrica em todo o país.

Rapidez na entrega e excelentes preços em peças e acessórios originais.

Instramed - A marca brasileira de tecnologia médica

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

• Dimensões com pás:
- 44,5 cm (Largura).
- 24,5 cm (Profundidade).
- 20,0 cm (Altura).

• Peso:
- Aparelho - 3,90 Kg.
- Pás externas - 0,85 Kg.

• Bateria interna:
- Tipo: NiMH, 14,4 VDC 4 A/h.

• Duração:
- Bateria em boas condições com carga plena - mínimo de 140 choques em 360 joules ou mínimo de 200 choques em 200 joules.
- Tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada): 8 horas.

• Armazenamento da bateria:
- O armazenamento da bateria por longos períodos em temperaturas acima de 35°C reduzirá sua capacidade e vida útil.

• Classificação:
- Equipamento energizado internamente.
- Tipo CF.

• Modo de funcionamento:
- Operação frequente.

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

• Temperatura:
- Operacional: 0 a 50 °C.
- Armazenamento: 0 a 70 °C.

• Umidade:
- Operacional: 10 a 95% RH, sem condensação.
- Armazenamento: 10 a 95% RH, sem condensação.

DESFIBRILADOR

• Desfibrilação adulto/externa:
- Escalas: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules.
- Energia máxima limitada a 50 J com pás internas ou infantis.

• Forma de onda:
- Exponencial truncada bifásica.
- Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente.

• Aplicação de choque:
- Por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação.

• Comandos:
- Teclas de comando: CARGA, APLICA, ANULA e SINCRONISMO, operando na sequência padrão "1 – 2 – 3", localizadas no painel superior do equipamento.
- Chave Seletora: permite ligar/desligar o aparelho, assim como selecionar as escalas de energia e acionar o modo de teste funcional.

• Comando de carga:
- Botão CARGA no painel frontal
- Botão nas pás externas.

• Comando de choque:
- Botão APLICA no painel frontal
- Botão nas pás externas.

• Comando de anula:
- Botão ANULA no painel frontal.

• Comando sincronizado:
- Botão SINC no painel frontal.

• Indicadores de carga:
- Sinal sonoro de equipamento carregando.
- Sinal sonoro de carga completa.
- LED nas pás externas e nível de carga indicada no display.

• Tempo máximo de carga:
- Rede e bateria < 6s.

• Tamanho dos eletrodos:
- Adulto: 10,3 cm x 8,5 cm. (Área de contato: 81,9 cm^2)
- Infantil: 4,5 cm x 4,0 cm. (Área de contato: 18 cm^2)

• Cardioversão:
- <60ms.

• Pás (opções):
- Adulto e infantil externas (inclusas).
- Adulto e infantil internas: (opcionais).

• Tensão de saída máxima:
- 2000 V.

• Corrente de saída máxima:
- 80 A (25 ohms).

DISPLAY

• Indicação de nível de bateria:
- Sim.

• Tamanho:
- 99 mm x 19 mm

• Tipo:
- LCD alfanumérico.

NORMAS:

- NBR IEC 60601-1
- NBR IEC 60601-1-2
- NBR IEC 60601-1-6
- NBR IEC 60601-1-8
- NBR IEC 60601-2-4

ou IEC's equivalentes

Folder Apolus PORT R1.4 - 2016

Instramed Ltda.
Beco José Paris, 339 - Pavilhão 19
CEP 91140-310 Porto Alegre RS Brasil
Tel.: (51) 3073 8200

WWW.INSTRAMED.COM.BR

ANVISA 10242950011

INSTRAMED