

LONDRINA, 05 de JUNHO de 2023

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO  
ESTADO DO CEARÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS  
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1905.0112023.PE

**LondriHosp**  
Materiais Hospitalares




**PROPOSTA**

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	VLR UNIT R\$	VLR TOTAL R\$
01	01	ANALISADOR HEMATOLOGICO-TELA DE 8,5"- TOUCH SCREEN COLORIDA- 21 PARÂMETROS C/03 DIFERENCIAIS. • 21 parâmetros com 3 partes diferenciais WBC, Lym#, Nid#, Gran#, Lym%, Nid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, NCV, MCH, NCHC, ROW - CV, RDW-SD, PLT, NPV, POW, PCT, P-1-CR, P-1-CC. 3Histogramas: WBC, RBC e PL-T; Especificações Técnicas Principios: • Método de impedância para contagem de RBC, PLT e WBC; • Dosagem de hemoglobina com reagentes livre de cianeto; • 21 parâmetros + 3 histogramas • Abertura de contagem com diâmetro de 70um Aspiração de IOul de amostra Ampla capacidade de armazenamento: + 40.000 resultados com gráficos; • Velocidade: 35 amostras por hora • Calibrações: automática e manual Diluição automática com apenas um dique • Limpeza pós amostra executada com alta tensão UNO 1 R\$ 67 681 33 R 67 681 33 • Controle de igualdade com XB, Levey-Jennings, SD e CV • Display Touch Screen Precisão: • WBC < 0,5%, RBC < 0,5%, HGB < 0,5%, PLT € 2 /o Modo de Trabalho: • Direção linear de contagem e sistema de detecção de HGB independente Condições de Operação: • Temperatura de 15°C 30°C • Umidade 10% a 85% Impressão do Resultado: • Impressora térmica interna • Opcional: impressora externa Performance: Parâmetro: GB / GV /HGB / NCV/ PLT Limite de linearidade: 0,5 99,9x10 9/L0,2 9,99x10 12/L 1,0 299,9 g/l- 40200 fL O 999x10 9/L Precisão: CV < 2,0aJo / CV4 1,5% / CV€ 1,5/o / CV€0,5% / CV€ 4,0/o Energia: • 100 264V - 50 60H Consumo: ' Apenas 3 reagentes • Lisante • Diluente Lavagem Peso: • 20 kg Dimensões: 20 kg Opcionais: Impressora Leitor de código de barras	MEDMAX MNAXCEL 300BR	35995,00	35.995,00
VALOR DA PROPOSTA R\$ 35.995,00 TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS			VLR TOTAL PROPOSTA	35.995,00	

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 dias

  
GUSTAVO HENRIQUE CARREGA  
DIRETOR COMERCIAL  
CPF 084.265.219-16

42.650.279/0001-07  
I. E. 90899891-05  
LONDRIHOSP IMP. E EXP. DE  
PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA  
RUA MARIA DONIAK, 133  
JD. TROPICAL - CEP 86087-635  
LONDRINA - PR

GUSTAVO  
HENRIQUE  
CARREGA:08  
426521916

Assinado de forma digital por  
GUSTAVO HENRIQUE  
CARREGA:08426521916  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,  
ou=AC SERASA RFB,  
ou=32584223000130,  
ou=VIDECONFERENCEIA,  
cn=GUSTAVO HENRIQUE  
CARREGA:08426521916

## DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

A empresa **LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ 42.650.279/0001-07 localizada na Rua Maria Doniak, 133 – Jardim Tropical – Londrina – PR, CEP 86087-635 vem por meio desta apresentar a proposta para o fornecimento do objeto da presente licitação, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

**Declaramos que os produtos ofertados atendem as especificações estabelecidas no edital e que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.**

**Declaramos** para os fins do tratamento diferenciado e favorecido que cogita a Lei Complementar nº 123/2006 que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** e que não estamos incurso nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

**Declaramos, sob as penas da lei, que o edital e seus anexos foram colocados à nossa disposição, e tomamos conhecimento de todas as informações, condições, locais e grau de dificuldade para execução do objeto da licitação, bem como, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.**

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados na presente licitação. Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para participação e habilitação de nossa empresa na presente licitação, ciente da obrigatoriedade de declarar, caso ocorram fatos posteriores que nos inabilite a participar de licitações. Declaramos ainda que a empresa não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública.

**Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/1993, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, NÃO POSSUINDO, AINDA, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos. Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. Declaramos que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social que atendam**



às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Declaramos que os sócios e seus representantes não possuem parentesco, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, com os servidores e agentes políticos envolvidos no processo licitatório, e com poder decisório capaz de influenciar no resultado, independentemente da modalidade licitatória.

Declaramos em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada para participar do referido Pregão foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do referido Pregão quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada para participar do referido Pregão não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração da licitante, antes da abertura oficial das propostas.

**Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.**

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Prazo de Pagamento: Conforme edital.

Prazo de Garantia: Conforme o edital.

Procedente: Nacional

**Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – AG: 1582-2 - C/C: 30.803-X**

**Representante Legal responsável pela assinatura de Atas e Contratos:**


**Gustavo Henrique Carrega**

**CPF: 084.265.219-16 RG: 12.640.687-8**

**Endereço residencial: Rua Tupi, 329 – Centro, Londrina – PR CEP: 86020-350**

**E-MAIL: londrihosplicitacao@gmail.com**

Londrina, 02 de junho de 2023.

  
GUSTAVO HENRIQUE CARREGA  
DIRETOR COMERCIAL  
CPF 084.265.219-16


42.650.279/0001-07  
I. E. 90899891-05  
LONDRIHOSP IMP. E EXP. DE  
PROD. MÉDICO HOSPITALARES LTDA  
RUA MARIA DONIAK, 133  
JD. TROPICAL - CEP 86087-635  
LONDRINA - PR

GUSTAVO  
HENRIQUE  
CARREGA:084  
26521916

Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916  
DN: c=BR, o=K-P-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=32584223000130, ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=GUSTAVO HENRIQUE CARREGA:08426521916

# CONTADOR HEMATOLÓGICO

# MaxCel 300 BR

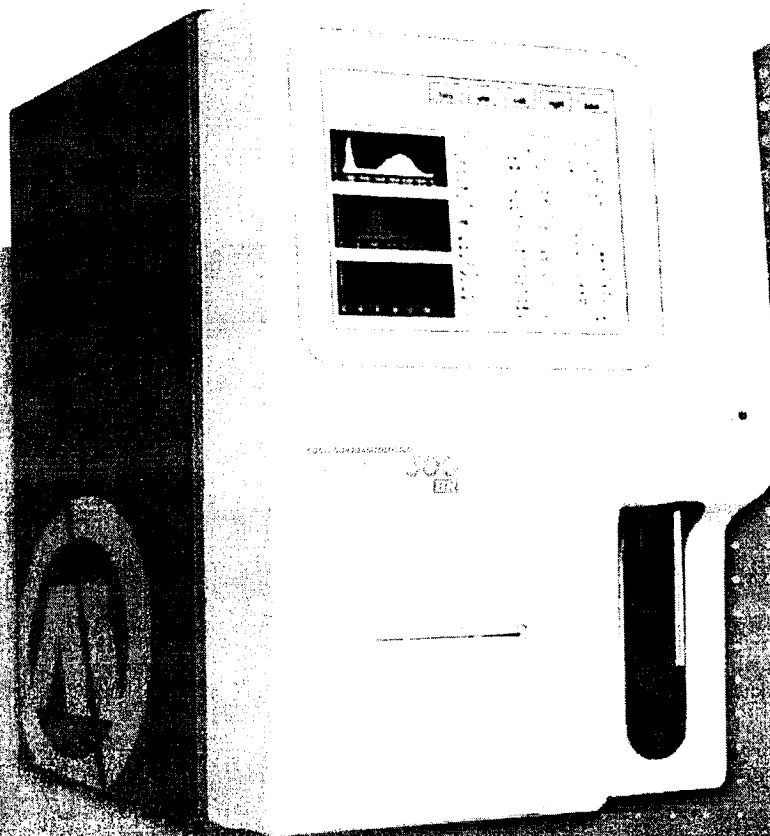

ATE  
**60**  
SEGUNDOS/HORA

**23**  
PARÂMETROS

**2**  
REAGENTES

RMS-810137-0015

## Mais Agilidade • Mais Custo-Benefício • Fabricado no Brasil

Com o MaxCel 300BR, sua rotina laboratorial vai revolucionar sua rotina laboratorial! Utilizando apenas dois reagentes o novo MaxCel 300BR é indispensável em seu laboratório de análises clínicas. Com ele você ganha mais agilidade no diagnóstico e bem-estarimento de seu paciente com resultados de 23 parâmetros em apenas 60 segundos, garantindo o tratamento adequado e no tempo certo.



**BPF**  
Laboratorial



# Especificações Gerais:



- 60 Amostras/hora;
- 23 parâmetros de leitura
- Aspiração de apenas 9,8ul de amostra;
- Memória para mais de 30 mil resultados;
- Apenas 02 Reagentes (01 Lisante e 01 Diluente);
- Display LCD Touch Screen de 8,5 polegadas;
- Circuito Hidráulico separado do Circuito eletrônico;
- Contagem de WBC e RBC por impedância elétrica e HGB por colorimetria;
- Leitor de códigos de barra (Opcional);
- Impressora térmica de alta resolução (papel termo sensível 80mmx30mm);
- Bivolt automático;
- Saídas USB, RS232 e VGA;
- Conexão com mouse, teclado e impressora externa via USB;
- Peças de alta qualidade;
- Peso 20 Kg.

WBC	NEUT#	MCHC	PCT
LIN%	HGB	RDW-SD	P-LCR
LIN#	RBC	RDW-CV	Histograma WBC
MID%	HCT	PLT	Histograma RBC
MID#	MCV	MPV	Histograma PLT
NEUT%	MCH	PDW	-



## Fabricado no Brasil

Em outubro de 2021 a Medmax anuncia a expansão de suas atividades ao concluir a primeira fase do projeto de ampliação de sua fábrica localizada em Santa Rita do Sapucaí/MG e apresenta ao mercado os primeiros novos equipamentos da Linha MaxCel manufaturados nacionalmente.

O lançamento dos novos equipamentos MaxCel 300BR, MaxCel 300BR Vet e MaxCel 620BR traduzem parte desse movimento de expansão e revela um pouco das novidades que ainda estão por vir.

Com design moderno e diferenciado, os novos analisadores hematológicos contam com componentes de alta qualidade e confiança, desenvolvidos por fabricantes de referência no mercado mundial além de cumprirem rigorosos padrões de segurança e qualidade em sua cadeia de produção como a Certificação de Boas Práticas de Fabricação (BPF) concedida pela ANVISA.




Linha de montagem do novo MaxCel 300BR

Rev. 1 - 26/11/2021

@medmaxbrasil  
 @medmaxbrasil  
 @medmaxbrasil  
 medmaxbrasil  
 Av. Celso de Figueiredo, 115 - Jardim I - SP  
 www.medmaxbrasil.com.br

MaxCel 300BR



## PROPOSTA DE PREÇOS

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO/CE  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1905.01/2023

### DADOS DA LICITANTE:

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>BLESS BRASIL SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA</b>
<b>CNPJ</b>	44.587.313/0001-63
<b>INSCR. ESTADUAL</b>	797829118110
<b>INSCR. MUNICIPAL</b>	20140287
<b>OPTANTE SIMPLES</b>	SIM
<b>FONE/FAX</b>	(016) 3235-6130
<b>E-MAIL</b>	licitacao@blessbrasil.com.br
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Jose da Costa Teixeira, 606 - Recanto das Flores - Ribeirão Preto – SP CEP: 14110-000
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	<b>Favorecido:</b> Bless Brasil Servico e Comercio De Artigos Para Saude LTDA. <b>CNPJ:</b> 44.587.313/0001-63 <b>Banco:</b> 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. (BANCOOB/SICOOB) <b>Agência:</b> 3188 - Presidente Vargas <b>Conta Corrente:</b> 138076-1

### REPRESENTANTE LEGAL inclusive para assinatura do contrato e outros documentos inerentes:

Sr. Sérgio Luiz de Sousa Gandini, maior, capaz, nacionalidade: Brasileira, casado, comerciante, nascido(a) em: 22/08/1955, filho de Rosa Conceição de Sousa Gandini e Antônio Gandini Filho, portador do RG: 9.799.709, inscrito no CPF sob o No. : 833.684.778-20, Residente à AV. Jorge Cechetto, 702FD – Nova Matão – Matão – SP – CEP: 15.990-620

TEL: (16) 3235-6130 - (16) 99640-0880 FAX:(16) 3235-6130 e-mail: licitacao@blessbrasil.com.br

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	Qty Unid	MARCA MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	<b>OFERTAMOS:</b> ANALISADOR SEMI AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA SISTEMA OPERACIONAL EM WINDOWS. TELA "TOUCH 2 SCREEN" DE 7 POLEGADAS (800*480 PIXELS). 5 PORTAS USB E PORTA HERNET, ANÁLISE COM CUBETA DE FLUXO E CUBETA DE REAÇÃO. ARMAZENAMENTO DE MAIS DE 300 PROGRAMAÇÕES E 200000 RESULTADOS DE AMOSTRA. MÉTODOS DE TESTE: PONTO FINAL, DOIS PONTO PONTO FINAL, CINÉTICO, TEMPO-FIXO SISTEMA ÓPTICO: 7 FILTROS (340, 405, 450, 505, 546, 578 E 630 NM) E MAIS DOIS OPCIONAIS LÂMPADA: HALÓGENA / cS fie11 DE TUNGSTÊNICO (6V10W) COM FUNÇÃO STAND-BY DISPLAY: TELA TOUCH SCREEN DE 7 POLEGADAS f FLS " (800480 PIXELS) IMPRESSORA: INTERNA TÉRMICA PARA -- PAPEL DE 57 MM. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 25, 30 E C4 370 C E TEMPERATURA AMBIENTE CAPACIDADE DA I "FLOW CELL" E CAMINHO ÓPTICO: 32 PI- , 10MM RESOLUÇÃO: 0.0001 ABS FAIXA FOTOMÉTRICA: 0.000- 4.000 ABS CPU : ARN CORTEX-A8, 720 NHZ MEMÓRIA: DDR2 SDRAN. 1 GIGA MEMÓRIA FLASH: 256 NB INTERFACE: 5 PORTAS USBI 1 PORTA ETHERNET CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO:	01 Unid.	<b>SINNOWA</b> Modelo: <b>SX-3000M</b>	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00



TEMPERATURA 10- 30°C, UMIDADE: 30-80% ALIMENTAÇÃO: 100-240 V, 50-60 HZ Garantia de 12 meses Marca Sinnova – Modelo SX3000m Registro no MS-ANVISA: 81452980009				
---	--	--	--	--

**Total da Proposta = R\$ 9.500,00 (Nove Mil e Quinhentos Reais)**

### PRAZOS:

PAGAMENTO: Até 30 Dias após entrega definitiva.  
ENTREGA: Até 20 dias após recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO.  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias a partir de sua apresentação.

### DECLARAÇÕES:

DECLARAMOS, sob as penas da lei:

- A) que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;
- B) Para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Ribeirão Preto, 05 de junho de 2023.

**BLESS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA**

**CNPJ: 44.587.313/0001-63**

**Sérgio Luiz de Sousa Gandini**

**RG: 9.799.709**

**CPF: 833.684.778-20**

**Diretor Geral - Representante Legal**

44.587.313/0001-63  
BLESS BRASIL SERVIÇO  
E COMERCIO DE ARTIGOS  
PARA SAUDE LTDA  
Rua José da Costa Teixeira, 608  
Distrito de Bonfim Paulista  
Recanto das Flores-CEP 14110-000  
RIBEIRÃO PRETO - SP

# SINNOWA



HEALTHCARE

CE

ISO  
13485



Registro:  
80508180002

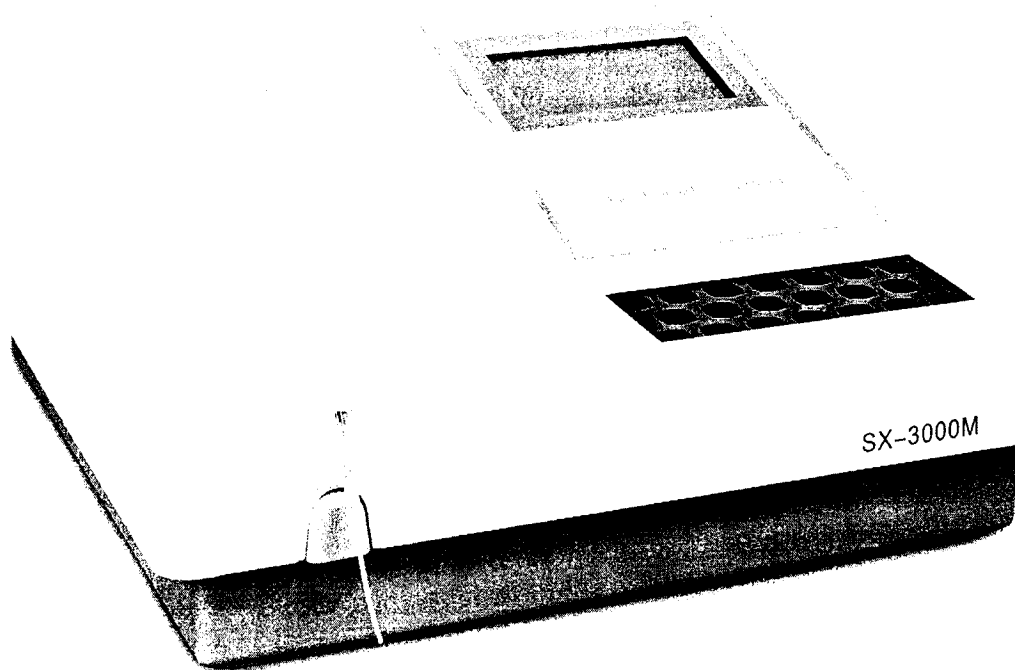

## SX-3000 M

ANALISADOR BIOQUÍMICO

Semiautomático





	CARACTERÍSTICAS SINNOWA	TECNOLOGIA SINNOWA	BENEFÍCIOS
	Métodos	Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética e absorbância); Turbidimetria (fator ou curva de padrões e padrão); ELISA em tubos.	Leituras mono e bicromáticas. Fluxo contínuo e cubeta 32uL (vidro de quartzo 10mm).
<b>INOVAÇÕES</b>	Incubadora Embutida	<b>EXCLUSIVO</b> bloco térmico (banho seco) com 20 posições para tubos de amostras.	Pré-incubação das amostras. Dispensa uso de banho maria.
	Impressora	Tipo térmica (57mm) embutida.	Rápida e silenciosa.
	Monitor	Monitor LCD - 7,8" - Touch Screen. Acompanha caneta dedicada.	Ícones tipo Pop-up. Fácil utilização.
	Memória	Alta capacidade. Tipo contínua.	200 programações de reagentes. Mais de 10.000 resultados de testes.
<b>SISTEMA FOTOMÉTRICO</b>	Fonte de Luz	Lâmpada de Halogênio / Tungstênio. 6v-10w ou LED (opcional).	Sistema stand by. Longa duração + 2000H.
	Filtros	Até 9 (sete fixos + 2 opcionais). Range a escolher entre 340 a 800nm.	Ampla cobertura. Longa durabilidade.
	Precisão dos Filtros	Banda de passagem de 2nm a 8nm.	Resultados precisos.
<b>SISTEMA DE LEITURA</b>	Princípios de Reação	Absorbância, ponto final (com e sem branco de reagente/amostra); Cinética; Tempo fixo; Dois pontos; Diferencial; Bi Cromático; Cálculo Fator; Curva de Calibração - (linear e não linear). Padrão ou múltiplos padrões; Fator, solução de soro, exponencial, polinomial, parábola.	Realiza todos os tipos de Bioquímica e Turbidimetria. Bomba peristáltica. Aspiração entre 150 e 2000µL.
	Escala de Medição	-0,100-4,500 O.D.	Acurácia e reprodutibilidade de resultados.
	Linearidade Fotométrica	± 2% (-0,100-4,500 O.D).	
	Exatidão Fotométrica	± 1% (-0,100-4,500 O.D).	
Desvio	≤ 1%.		
<b>CONTROLE TEMPERATURA</b>	Temperaturas de Reação	Sistema controlado por Peltiers. Regulável entre 20°C e 40°C.	Precisão de ± 0,1 °C.
<b>SOFTWARE</b>	Sistema Operacional	Versões em Inglês e/ou Português. Saídas RS232 (dados) e USB (Acessórios).	Permite teclado e mouse externo. Fácil utilização.
	Controle de Qualidade (CQ)	Completo incluindo gráficos de Levey Jennings, gráficos X-R e regras múltiplas de Westgard.	Resultados armazenados na memória.
<b>DIMENSÕES</b>	Medidas	Altura 16cm - Largura 35cm Profundidade 37cm.	Compacto.
	Peso	8Kg.	Leve e portátil.
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	100 a 240v	Bivolt automático.	Proteção contra queda de energia.